

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вольтметр цифровой V-03 предназначен для измерения величины напряжения в однофазных и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Вольтметр оборудован кнопочными переключателями для выбора вида измеряемого напряжения (фазное, линейное).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Напряжение питания | В, Гц | 220±10%; 50 |
| Диапазон измерений фазного напряжения | В | 30...300 |
| Диапазон измерений линейного напряжения | В | 52...520 |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 8 |
| Метод измерения | | среднеквадратичный |
| Класс точности | | 1,0 |
| Время обновления показаний | сек | 0,36 |
| Габаритные размеры блока | мм | 71 X 90 X 60 |
| Масса, не более | кг | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур (без конденсата) | °C | -40 ... +45 |

Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99

3. КОНСТРУКЦИЯ

Вольтметр цифровой V-03 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели вольтметра находятся цифровой индикатор, светодиодные индикаторы «L1», «L2», «L3» и соответствующие им кнопки.

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации цифрового вольтметра V-03.

4.2. Установить блок в электроощите на DIN-рейку.

4.3. Произвести подключение входной контролируемой сети, согласно маркировке (Рис.1.): для однофазной сети L1 – фаза, N – нейтраль; для трехфазной сети L1, L2, L3 – контролируемые фазы, N – нейтраль. Сечение подключаемых проводов должно быть 0,5... 1,5 мм кв.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!

Запрещается: вскрывать блок, находящийся под напряжением питающей сети.

5. РАБОТА

5.1. Включить сеть. При этом включится светодиод «L1» и на цифровом индикаторе будут текущие показания напряжения первой фазы. Для измерения фазного напряжения по второй или третьей фазе (трехфазная сеть) нажать кнопку «L2» или «L3», соответственно. При этом включится светодиод «L2» или «L3», а на цифровом индикаторе будут текущие показания измеряемого фазного напряжения. Для измерения линейного напряжения необходимо нажать две кнопки, например «L1» и «L2» с интервалом не более 1-2 сек, при этом включится светодиод «L1» и «L2», а на цифровом индикаторе будут текущие показания измеряемого линейного напряжения.

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможная неисправность | Причина неисправности. | Устранение неисправности |
|---|--|---|
| 1. При включении напряжения питания нет индикации | 1.Плохой контакт в клеммной колодке. 2.Неисправность в схеме блока. | 1.Выключить сеть и проверить качество контактов в клеммнике. 2.Выключить сеть, снять вольтметр и обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя. |

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования блока V-03 – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия *при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения* в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Дата изготовления: _____


Номер изделия: _____

Дата продажи: _____


ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1 | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2 |
|------------------------------|------------------------------|
| Дата изготовления _____ | Дата изготовления _____ |
| Дата продажи _____ | Дата продажи _____ |
| Характер неисправности _____ | Характер неисправности _____ |
| Отметки об устранении _____ | Отметки об устранении _____ |
| Дата _____ | Дата _____ |
| Подпись _____ | Подпись _____ |

а)

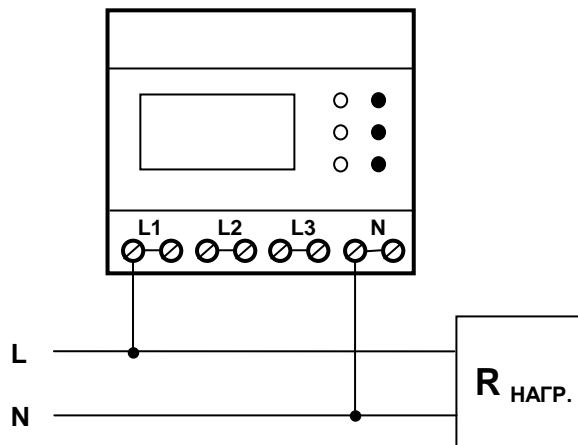

б)

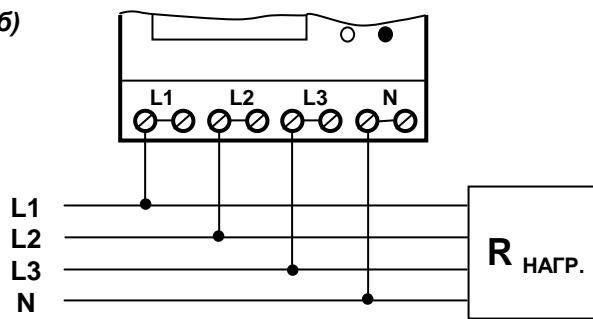

Вольтметр V-03

РОСС RU.МЛ02.Д00194
ТУ 4221-013-39441565-2005

Руководство по эксплуатации и паспорт

Рис.1. Типовая схема подключения вольтметра V-03: а) однофазная сеть; б) трехфазная сеть.

Предприятие производит:

- сетевые фильтры от 2.2 до 250 кВА;
- стабилизаторы напряжения от 0.05 до 250 кВА;
- трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА,
- устройства, нормализующие питание и защищающие электронную технику по цепям питания и заземления.

По вопросам поставок обращаться: 196084 Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 9, тел.(812) 327-07-06

Изготовитель ЗАО «ПФ «Созвездие»